Bronkhorst®

doc.no.: 9.20.267A
date.: 01-11-2021

RS232+E/S Analogiques

Schéma de câblage
MASS-STREAM
Version D-6400

Connexion RS232

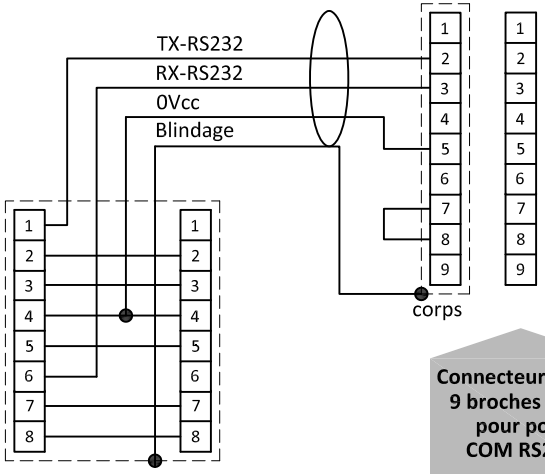

Connecteur D-sub 9 broches mâle pour port COM RS232

Câble avec connecteur en T 7.03.444

Descriptif de la carte électronique

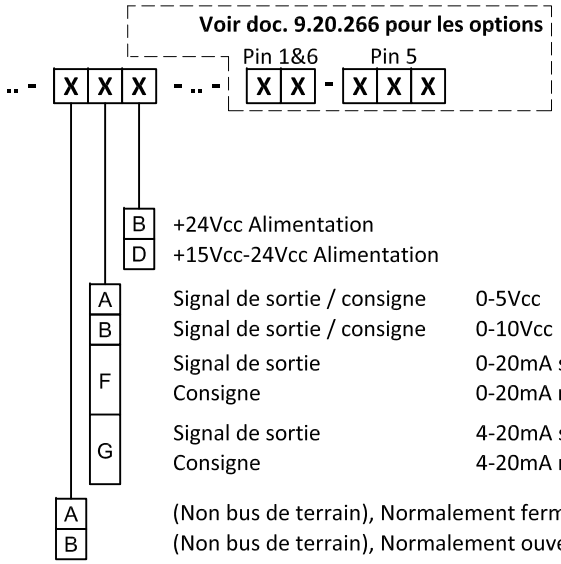

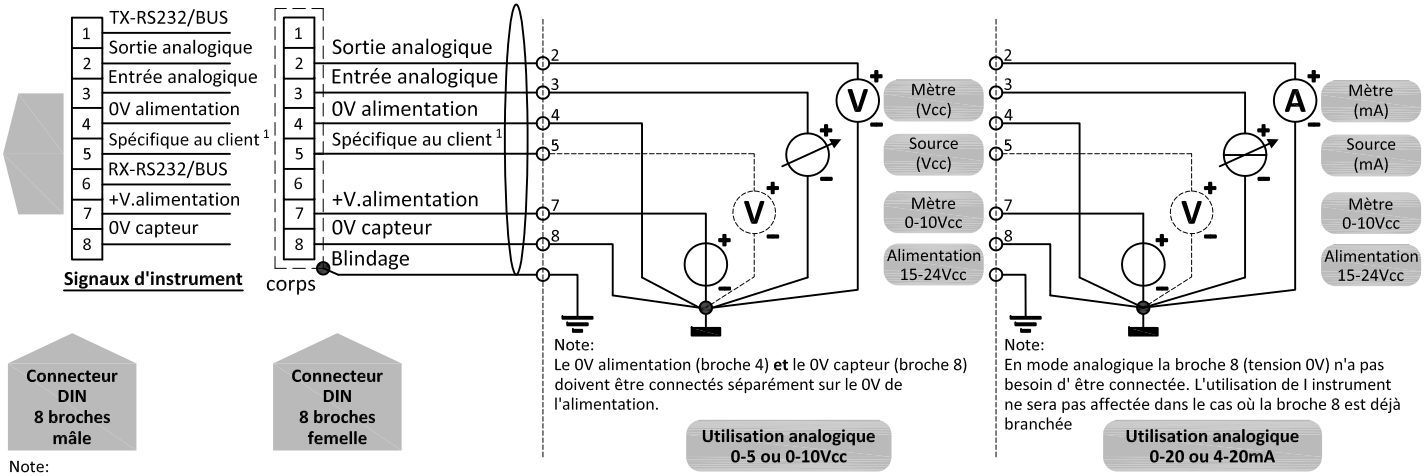

Connecteur DIN 8 broches mâle

Connecteur DIN 8 broches femelle

Note:
Le 0V alimentation (broche 4) **et** le 0V capteur (broche 8) doivent être connectés séparément sur le 0V de l'alimentation.

Utilisation analogique 0-5 ou 0-10Vcc

Note:
En mode analogique la broche 8 (tension 0V) n'a pas besoin d' être connectée. L'utilisation de l instrument ne sera pas affectée dans le cas où la broche 8 est déjà branchée

Utilisation analogique 0-20 ou 4-20mA

Note:
1) Désactivé par défaut, 0Vcc.

Note:
Lorsque l'instrument est utilisé en mode numérique (RS232 ou bus de terrain), la consigne analogique ne peut être utilisée qu' après avoir modifié la valeur du paramètre 'control mode'.
Voir doc. 9.21.023 pour plus de détails.
Ne pas raccorder une vanne externe à un instrument configuré en débitmètre ou capteur de pression.